


LCT-IIP Series

카스코리아 www.caskorea.co.kr

Load Cell Voltage/Current Transmitter

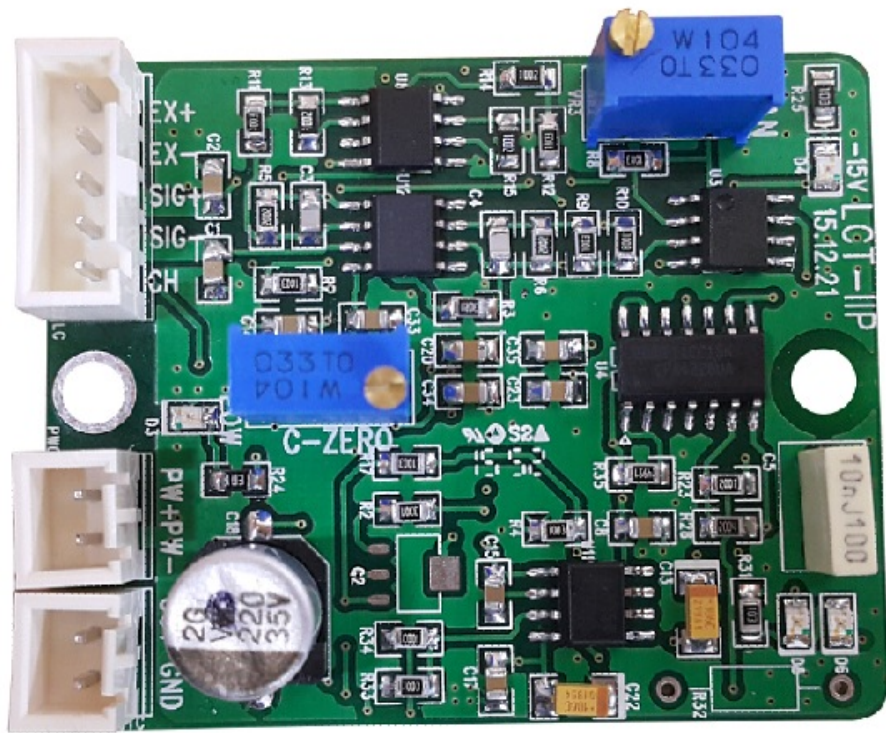

이용안내서

LCT-IIP SERIES

이용 안내서

경기동 성남시 중원구 갈마치로 302
성남우림라이온스밸리5차 B-1208

TEL: 031-750-0780

FAX: 031-750-0784

www.caskorea.co.kr

목차

1장	개요	
	LCT-IIP Series의 기능과 특징	1
2장	사양	
	LCT-IIP Series의 사양	2
3장	외부명칭	
	LCT-IIP Series의 외부명칭	3
4장	작동	
	트랜스듀서 연결	4
	영점조정	5
	스판조정	
5장	아날로그 전압출력	6
	사용시 유의사항	7
6장	Transmitter 노이즈 줄이는 법	8

개요

LCT-IIP Series 의 기능과 특징

LCT-II Series 는 Load Cell 전용전송기로서 단일전원으로 구동되며 로드셀 뿐 아니라 스트레인 게이지 타입의 각종 트랜스듀서의 출력을 전압 및 전류의 형태로 전송할 수 있도록 설계되었으며 산업현장에 가장 적합한 전압/전류 전용전송기이다.

LCT-IIP Series는 다양한 형태의 전압과 전류를 동시에 출력할 수 있다.

전 압 / 전 류 전 송

단일 전원 구동

서지전압보호

출력

특징1

Load Cell 전용전송기로서 추가의 증폭기 및 전송기가 필요 없다.

특징2

단일전원으로 구동하며 전원 입력단에는 Surge Absorber가 내장되어 산업현장에서 유발되는 각종 Surge 전압으로부터 보호할 수 있다.

특징3 출력특성. 전압 $DV \pm 0 \sim 5V$


Model No LCT-IIP- X

로드셀 입력레인지

1: 전압입력 : $1 \sim 1.5mV/V$


2: 전압입력 : $2 \sim 2.5mV/V$

사양

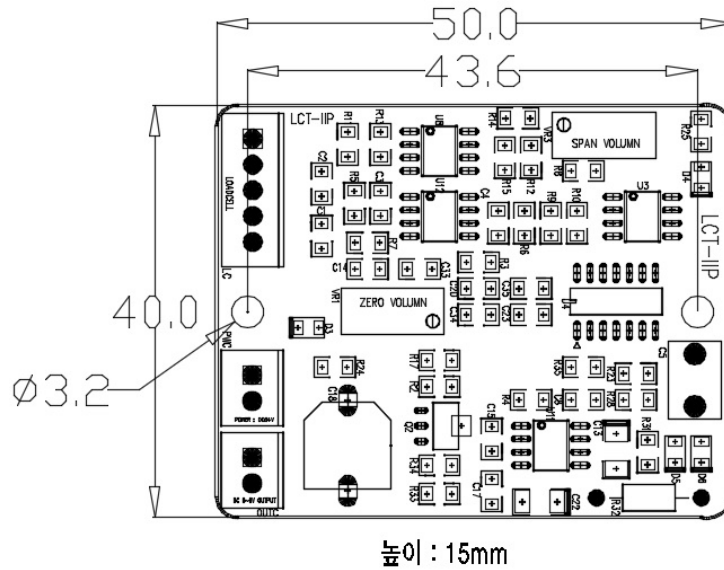

	Voltage Output Transmitter
모 델	LCT-IIP
출 력	± DC 0~5V
전원 (정전압)	+ DC 24V
아날로그 신호입력	1 ~ 1.5 mV /V
입력 임피던스	≤ 10 ¹⁰ Ω
트랜스듀서 인가전압	5V 정전압
영점발란스	±30% (R.O)
스판발란스	±30% (R.O)
직선성오차	±0.05% (F.S)
정확도	±0.05% (F.S)
사용 온도, 습도	-25 ~ +85℃, 85% R.H 이내
로드저항	1.7 KΩ 이상

명칭

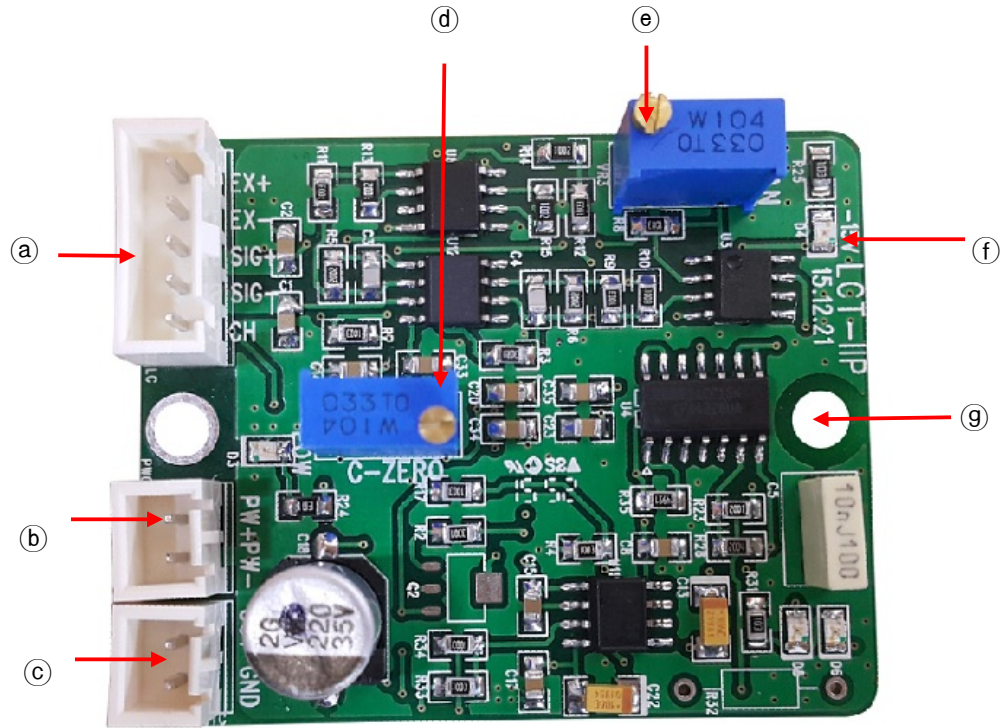

- ㉑ : 로드셀 콘넥터(케이블 별도 제공)
- ㉒ : 전원콘넥터 (DC 24V 정전압) (케이블 별도 제공)
- ㉓ : Analog out 콘넥터(DC 0~5V) (케이블 별도 제공)
- ㉔ : 영점조정볼륨(Coarse ZERO)
- ㉕ : 스판볼륨
- ㉖ : 전원 LED(-15V PW]
- ㉗ : PCB 고정 HOLE


주의사항

1.전원은 반드시 SMPS 전원이 아닌 리니어 전원을 사용하여야 한다.

(특히 DC POWER SUPPLY 전원은 사용하면 않됨)

작동

트랜스듀서 연결

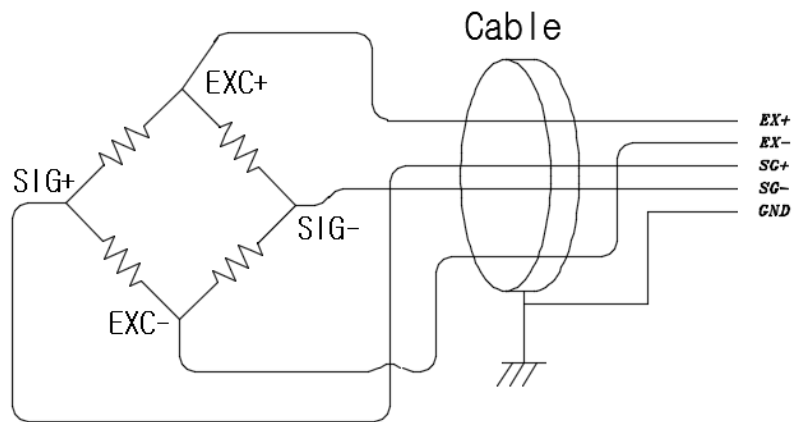

LCT-IIP Series와 트랜스듀서는 Shield Cable에 의해 연결한다. 트랜스듀서 제조업체별로 입출력선의 극성을 색깔로 표현하는 경우에는 색깔에 유의하며 연결한다.

제조업체	EX+(입력+)	EX-(입력-)	SG+(출력+)	SG-(출력-)	SHIELD(GND)
CAS	Red	White	Green	Blue	Black
CURIO	Red	White	Green	Blue	Black
KYOWA	Red	Black	Green	White	Cover
SHINKOH	Red	White	Green	Blue	Cover
BLH	Green	Black	White	Red	Cover
MODEL: PW4M	Blue	Black	White	Red	Yellow



영점조정

1. 인가전원 및 트랜스듀서를 연결한 다음 30분간 Warm up 한다.
2. D.V.M 이나 인디케이터를 사용하여 전송기 출력단과 연결한다.
3. 드라이버를 사용하여 0.000 V 가 표시되도록 C-Zero 볼륨을 조정한다.
4. Zero 볼륨을 끝까지 돌려도 0.000 V 가 표시되지 않으면 트랜스듀서에 문제가 있거나 초기로드가 걸려있을 가능성이 있다. 이때는 추가저항을 트랜스듀서에 달아 Zero Balance를 잡거나 트랜스듀서 제조업체에 영점범위를 문의한다.
5. Zero 볼륨을 돌려도 디스플레이값이 변하지 않으면 트랜스듀서가 불량이거나 터미널 연결을 잘못했을 수도 있으니 확인한다.

스판조정



스판조정을 시작하기 전에 트랜스듀서는 초기 영점상태에 있어야 한다.


본 전송기는 로드셀 입력전압을 order code에 맞게 사전에 주문이 필요함

1. 알고있는 실하중 혹은 부하를 가해 원하는 값이 표시되도록 게인을 조정한다. 예를 들어 1.5mV/V 정격출력, 200 Kg 정격하중을 갖는 로드셀이 있다고 하자. 이때 전압전송기의 출력 특성이 0~5 V 라고 하면 최대하중 200 Kg을 가하고 Span 볼륨을 5.000 V 가 표시되도록 조정한다..
2. 다시 하중 혹은 부하를 제거하고 영점을 확인한다. 영점이 맞지않으면 영점을 맞추고 위의 과정을 반복한다.

아날로그 전압출력



LCT-IIP V_{xxx} Series는 다양한 형태의 전압을 출력하며 레코더나 오실로스코프, A/D Board 등의 입력단에 연결하여 사용하거나 2차 트랜스듀서 혹은 컨트롤의 입력에 사용하기에 용이하다. 아날로그 출력전압은 모델별로 다양하며 최대 6.5V 까지 출력된다. 연결방법은 ‘’ 드라이버를 사용하여 터미날의 GND 단자와 V_{out} 단자에 각각 연결하면 된다.

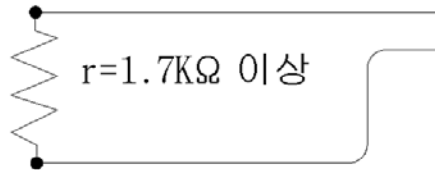

사용시 유의사항



LCT-IIP Series는 정밀한 전자회로모듈이다. 사용시 다음과 같은 사항에 유의해야 한다.

1. 사양에 의거하여 정전압을 공급한다.

전압 연결 시 역전압을 공급하지 않도록 주의한다

반드시 SMPS 전원이 아닌 리니어 전원을 사용하여야 한다
특히 DC POWER SUPPLY 는 NOISE LEVEL 및 주파수 NOISE가
높아 정밀 Transmitter에서 사용하는 것은 바람직하지 않다

추천 전원 : DC 24V 500mA 정전압 ADAPTER

아날로그 출력단과 트랜스듀서 입력단에 전원을 공급하지 않도록 유의한다.

2. 사양에 나와있는 온도와 습도 범위 내에서 사용한다.
3. 진동이나 기계적 충격이 있는 곳에서의 사용은 피하고 떨어뜨리지 않도록 주의한다.
4. 트랜스듀서 연결 시 배선에 유의한다.
5. 영점이나 게인 조정시 무리한 힘을 가하지 않도록 한다.
6. 영점이나 게인 조정시 무리한 힘을 가하지 않도록 하고 ‘↵’ 드라이버를 사용한다.


Transmitter 노이즈 줄이는법




1. Amplifier 전원을 DC24V 를 사용하되 반드시 SMPS 전원이 아닌 리니어 전원을 사용하여야 한다

2. 주위에 노이즈 성분을 가지는 장비 또는 모터(서버모터등)는 전원을 분리하여 앰프에 공급한다. - 반드시 접지 전원 공급

센서부에 전원 노이즈(60Hz)가 많은 경우에 센서 구조물(금속)에 접지라인을 뽑아 메인접지(메인 전원접지)에 연결하며 아울러 노이즈원 장비의 접지를 꼭 실시한다

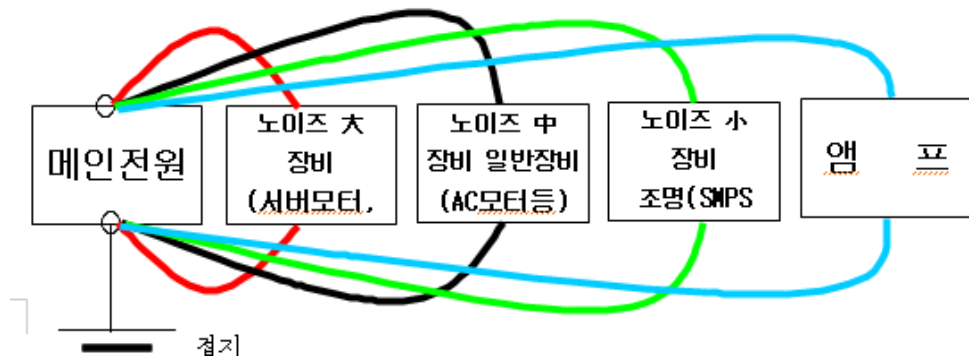

3. 신호 입력 계측기(인디케이터,AD board 등) 신호 입력단에 간단한 R.C Filter 를 부착한다

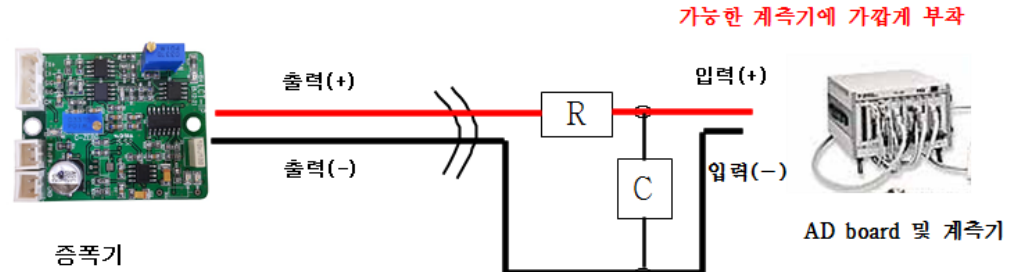

R.C filter 의 값은 저항은 작게 하여야 하며 계측기 입력 임피던스에 영향을 주므로 큰 저항은 삼가한다, 그리고 가능한 계측기에 가깝게 부착하여야 효과가 최대화 된다

추천소자의 값 : 저항(100 ohm 일반저항(0.1%급))

콘덴서 (0.01 μF / 폴리에스트, 폴리프로필렌)

계산식 : $FC(\text{주파수 Hz}) = 1 / (2\pi \times R(\Omega) \times C(\mu\text{F} \times 10^{-6}))$

4. 앰프의 주파수 특성을 개선하고자 할 때는 앰프 2 개를 직렬로 연결하여 사용하면 응답특성이 2 배로 향상된다. 이때는 앰프의 **개인저항**을 반드시 변경하여 사용하여야 한다.

이 회로는 0-5V 이내로 출력되는 대부분의 LVDT 에도 적용된다